БАТЛАВ
БҮС ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,
БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА Г. МӨНХЗАЯА

2026 оны 1 сарын 14 өдөр

**АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ ХУДАЛДАН АВАХ ГЕМОДИАЛИЗИЙН УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ АППАРАТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Гемодиализийн ус цэвэршүүлэх аппарат**

| д/д | | Нэр төрөл | Тоо ширхэг | | Хэмжих нэгж | Нийт үнэ | Техник үзүүлэлт | Зураг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Урвуу осмос Ус цэвэршүүлэх аппарат | **АРАЛ** | Зэвэрдэггүй ган хийцтэй | 1set | Иж бүрдэл /ком/ | 58,000,000 төгрөг | Ашиглалтын хугацаа урт, эдэлгээ удаан, монгол улсад албан ёсны эрхтэй, өмнө нь бусад эмнэлгүүдэд ашиглагдаж хэрэглээнд нэвтэрсэн байх | 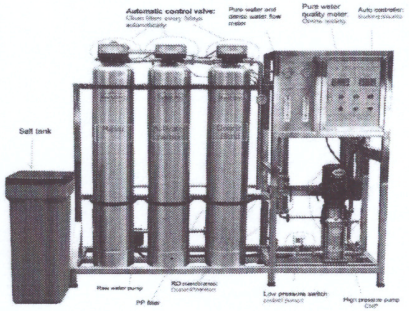 |
| | | **ЖИН/ДУНДАЖ/** | Ус бэлтгэх нэгж 280 кг, Модулийн нэгж нь 60кг | 340кд | | | | |
| | | **УС БЭЛТГЭХ НЭГЖ** | Raw water pump (Ус түгээх насос) SUS-304 | 1pc | | | | |
| | | Cam II QA Handle 8 тэлэгч | Quartz sand filter | 1set | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dn250x1450 (Хайрган шүүлтүүр) | | | | | |
| | | Micro Adj II Clip-On QA 10 тэлэгч | Activated carbon filter Dn250x1450 (Нүүрсэн шүүлтүүр) | 1set | | | | |
| | | Malleable 51*203mm тэлэгч | Water softener Dn250x1450 (Ус зөөлөрүүлэх шүүлтүүр) | 1set | | | | |
| | | **УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ КО МОДУЛЫН ХЭСЭГ** | Security filter High pressure pump | | | | | |
| | | Balfour 70*73mm тэлэгч | Security filter High pressure pump | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Balfour 78*73mm тэлэгч | Reverse osmosis water system Capacity 500L/h | 1set | | | | |
| | | **ЦАХИЛГААН** | Electric control system PC program controller | 1set | | | | |
| | | **ЦЭВЭРШҮҮЛСЭН УС ТҮГЭЭХ ХЭСЭГ** | Pure water tank 300L Pure water pump Final filter 0.22mkm UV sterilizer | 1set | | | | |
| | | **ТЭЖЭЭЛИЙН УСАН ХАНГАМЖ** | Тэжээлийн усан хангамж /КО оролтын | Төвлөрсөн системийн ус | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | хоолойн дээрх/ | | | | | |
| | | | Оролтын даралт | 2-6 Ваг | | | | |
| | | | Оролтын температур | 5-30$_0$С | | | | |
| | | | Хатуулаг | <1$^0$СН (Ѳ.2тто1Д) | | | | |
| | | | Агуулагдах хлор | <0.1 ppm | | | | |
| | | **ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ** | Цахилгааны хүчдэл | 220В 50Нг/16А | | | | |
| | | | Цахилгааны чадал | Max 2.5 кМ | | | | |
| | | **ХҮЧИН ЧАДАЛ** | RO систем Бүтээмж | 500 л/цаг /15$_0$С болон 3,0 Вар | | | | |
| | | | Бүтээмж | Хэвийн үед 70 хувь | | | | |

ХЯНАСАН: ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Г.АРИУНАА

БОЛОВСРУУЛСАН: БӨӨР, ГЕМОДИАЛИЗИЙН ИХ ЭМЧ Х.АЛТАНТОГОС